



Siedlce, dnia 24 października 2016

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
LEKARZ WETERYNARII
Beata Anna Tomanek

WYKONAWCY

- wszyscy -

Nasz znak: WIW-AD.272.85.2016

Dot. sprawy nr:

pismo z dnia:

Wyjaśnienie oraz zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami). Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach przesyła odpowiedzi na zadane pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy WIW-AD.272.85.2016 na **dostawę ciepłarek dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.**

Pytanie nr 1: Czy zamawiający wymaga aby każda z ciepłarek była dostarczona ze świadectwem wzorcowania w 3 podanych temperaturach, czy też każda z ciepłarek ma być wzorcowana w jednej temperaturze - proszę podać w jakiej temperaturze ma być wzorcowana ciepłarka z drzwiami prawostronnymi?

Odpowiedź nr 1: Każda z ciepłarek ma być wzorcowana tylko w jednej podanej temperaturze to znaczy:

Ciepłarka z drzwiami prawostronnymi w temperaturze 37°C.

Ciepłarka z drzwiami lewostronnymi w temperaturze 30°C.

Ciepłarka z drzwiami lewostronnymi w temperaturze 44°C.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach



zawiadamia, iż dokonał zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

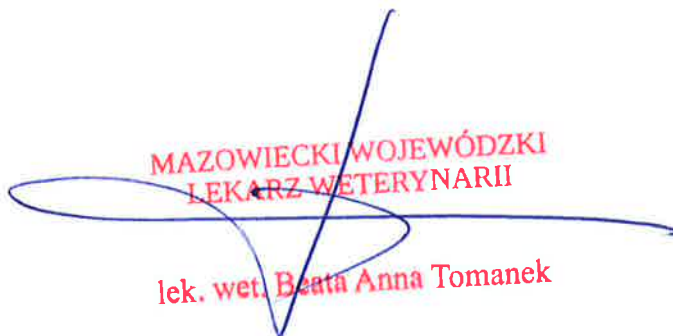
Zmiana polega na:

- 1) Zmianie opisu przedmiotu zamówienia (Opis – Parametry techniczne) dla pozycja nr 1 w Rozdziale XVII SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Przed zmianą: „wzorcowanie komory ciepłarki - pomiary wykonywane w 9 punktach pomiarowych (naroża + środek geometryczny) w temperaturach 30°C, 37°C i 44°C - wykonane w akredytowanym laboratorium”

Po zmianie: „Wzorcowanie komory ciepłarki - pomiary wykonywane w 9 punktach pomiarowych (naroża + środek geometryczny) w temperaturach:

- Ciepłarka z drzwiami prawostronnymi w temperaturze 37°C,
- Ciepłarka z drzwiami lewostronnymi w temperaturze 30°C,
- Ciepłarka z drzwiami lewostronnymi w temperaturze 44°C - wykonane w akredytowanym laboratorium”


MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
LEKARZ WETERYNARII
lek. wet. Beata Anna Tomanek

